



172816040506

本报告共 12 页 第 1 页

检测报告

(编号: 2022-HJBG009)

委托单位: 山丹自来水有限责任公司

项目名称: 生活饮用水常规指标分析

样品名称: 生活饮用水

检测类别: 委托检测


承检单位: 甘肃地质工程实验室有限责任公司 (盖章)


报告日期: 2022 年 1 月 24 日




扫描全能王 创建

检测报告

样品名称	生活饮用水	检测编号	2022-HJ0050-0054	
项目名称	生活饮用水常规指标分析	样品类型	水源水、出厂水、末梢水	
委托单位	山丹自来水有限责任公司	样品形态	液态	
采样位置	详见检测结果表	检测类别	委托检测	
样品数量	3.5L/组水样, 共 5 组水样	送样日期	2022 年 1 月 7 日	
样品基数	/	采样者	舒祥清	
检测依据	生活饮用水卫生标准 GB5749-2006	样品状态	符合检测要求	
检测项目	生活饮用水常规指标 42 项。	环境条件	温 度	20~22 °C
			相对湿度	35~40 %
主要检测仪器	Agilent 7890B-5977B 型气相色谱-质谱联用仪、Agilent 7800 型电感耦合等离子体质谱仪、ThermoFisher 7400 型电感耦合等离子体发射光谱仪、北京宝德 BAF-4000 原子荧光光度计、普析 TU-1810 型可见紫外分光光度计、北京宝德 BDFIA-7000 型流动注射分析仪、湖北方圆 FYFS-400X 型四通道 α β 测量仪等。			
检测结论	<p style="text-align: center;">本次检测为来样送检, 仅对来样负责, 不做符合性判定, 检测结果详见检测结果表。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>检测专用章</p> <p>签发日期: 2022 年 1 月 24 日</p> </div>			
检测人员	何兴华、杜超、坚文娇、刘玉梅、高甜、董仓仁、殷艺暄等。			

编制: 

审核: 

批准: 





检测结果表

检测编号	2022-HJ0050	样品类型	污水处理厂	采样位置	陈位水厂	
取样日期	2022.01.07	收样日期	2022.01.07	检测日期	2022.01.07~20	
检测结果						
序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
1	色度	铂钴标准比色法	度	15	<5	达标
2	嗅和味	嗅气和尝味法	—	无异臭、异味	无	达标
3	浑浊度	福尔马肼标准目视比浊法	NTU	3	<1	达标
4	肉眼可见物	直接观察法	—	无	无	达标
5	pH 值	玻璃电极法	无量纲	6.5-8.5	8.09	达标
6	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3	1.3	达标
7	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	mg/L	0.05	<0.002	达标
8	挥发酚	流动注射-4-氨基安替比林分光光度法	mg/L	0.002	<0.001	达标
9	阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法	mg/L	0.3	<0.04	达标
10	硝酸盐 (以 N 计)	紫外分光光度法	mg/L	10	2.23	达标
11	氟化物	离子选择电极法	mg/L	1.0	0.209	达标
12	溶解性总固体	称量法	mg/L	1000	620	达标
13	总硬度	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	450	409	达标
14	氯化物	滴定法	mg/L	250	74.5	达标
15	硫酸盐	滴定法	mg/L	250	152	达标
16	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	<0.004	达标
17	铁	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.3	<0.01	达标
18	锰	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.1	0.0112	达标
19	铜	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	1.0	<0.00009	达标
20	锌	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	1.0	<0.009	达标
21	铝	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.2	0.060	达标
22	砷	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00035	达标




检测结果表

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
23	硒	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00151	达标
24	汞	原子荧光法	mg/L	0.001	<0.00004	达标
25	镉	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.005	<0.00006	达标
26	铅	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	<0.00007	达标
27	菌落总数	平皿计数法	CFU/mL	100	未检出	达标
28	总大肠菌群	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
29	耐热大肠菌群	多管发酵法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
30	大肠埃希氏菌	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
31	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	Bq/L	0.5	0.080	达标
32	总 β 放射性	薄样法	Bq/L	1	0.085	达标
33	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.06	<0.00003	达标
34	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.002	<0.00021	达标
35	亚硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.0024	达标
36	硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.005	达标
37	甲醛	乙酰丙酮分光光度法	mg/L	0.9	<0.05	达标
38	溴酸盐	离子色谱法	mg/L	0.01	<0.01	达标
39	游离氯	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	0.3-4	0.34	达标
40	一氯胺	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	0.5-3	0.51	达标
41	臭氧	靛蓝分光光度法	mg/L	0.3	<0.01	达标
42	二氧化氯	甲酚红分光光度法	mg/L	0.1-0.8	0.19	达标

以下空白




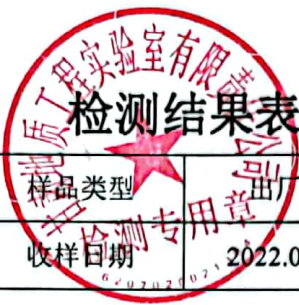

检测结果表

检测编号	2022-HJ0051	样品类型	出厂水	采样位置	山丹二水厂	
取样日期	2022.01.07	收样日期	2022.01.07	检测日期	2022.01.07~20	
检测结果						
序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
1	色度	铂钴标准比色法	度	15	<5	达标
2	嗅和味	嗅气和尝味法	—	无异臭、 异味	无	达标
3	浑浊度	福尔马肼标准目视比浊法	NTU	3	<1	达标
4	肉眼可见物	直接观察法	—	无	无	达标
5	pH 值	玻璃电极法	无量纲	6.5-8.5	8.20	达标
6	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3	1.3	达标
7	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	mg/L	0.05	<0.002	达标
8	挥发酚	流动注射-4-氨基安替比林分光光度法	mg/L	0.002	<0.001	达标
9	阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法	mg/L	0.3	<0.04	达标
10	硝酸盐 (以 N 计)	紫外分光光度法	mg/L	10	2.01	达标
11	氟化物	离子选择电极法	mg/L	1.0	0.175	达标
12	溶解性总固体	称量法	mg/L	1000	550	达标
13	总硬度	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	450	373	达标
14	氯化物	滴定法	mg/L	250	57.4	达标
15	硫酸盐	滴定法	mg/L	250	137	达标
16	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	<0.004	达标
17	铁	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.3	<0.01	达标
18	锰	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.1	0.00933	达标
19	铜	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	1.0	<0.00009	达标
20	锌	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	1.0	<0.009	达标
21	铝	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.2	0.009	达标
22	砷	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00020	达标





检测结果表

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
23	硒	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00167	达标
24	汞	原子荧光法	mg/L	0.001	<0.00004	达标
25	镉	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.005	<0.00006	达标
26	铅	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	<0.00007	达标
27	菌落总数	平皿计数法	CFU/mL	100	未检出	达标
28	总大肠菌群	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
29	耐热大肠菌群	多管发酵法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
30	大肠埃希氏菌	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
31	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	Bq/L	0.5	0.089	达标
32	总 β 放射性	薄样法	Bq/L	1	0.098	达标
33	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.06	<0.00003	达标
34	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.002	<0.00021	达标
35	亚硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.0024	达标
36	硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.005	达标
37	甲醛	乙酰丙酮分光光度法	mg/L	0.9	<0.05	达标
38	溴酸盐	离子色谱法	mg/L	0.01	<0.01	达标
39	游离氯	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	0.3-4	0.35	达标
40	一氯胺	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	0.5-3	0.53	达标
41	臭氧	靛蓝分光光度法	mg/L	0.3	<0.01	达标
42	二氧化氯	甲酚红分光光度法	mg/L	0.1-0.8	0.21	达标

以下空白





检测结果表

检测编号	2022-HJ0052	样品类型	水源水	采样位置	李桥水库	
取样日期	2022.01.07	收样日期	2022.01.07	检测日期	2022.01.07~20	
检测结果						
序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
1	色度	铂钴标准比色法	度	15	<5	达标
2	嗅和味	嗅气和尝味法	—	无异臭、 异味	无	达标
3	浑浊度	福尔马肼标准目视比浊法	NTU	3	<1	达标
4	肉眼可见物	直接观察法	—	无	无	达标
5	pH 值	玻璃电极法	无量纲	6.5-8.5	8.16	达标
6	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3	1.2	达标
7	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	mg/L	0.05	<0.002	达标
8	挥发酚	流动注射-4-氨基安替比林分光光度法	mg/L	0.002	<0.001	达标
9	阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法	mg/L	0.3	<0.04	达标
10	硝酸盐 (以 N 计)	紫外分光光度法	mg/L	10	1.95	达标
11	氟化物	离子选择电极法	mg/L	1.0	0.167	达标
12	溶解性总固体	称量法	mg/L	1000	560	达标
13	总硬度	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	450	372	达标
14	氯化物	滴定法	mg/L	250	56.0	达标
15	硫酸盐	滴定法	mg/L	250	146	达标
16	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	<0.004	达标
17	铁	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.3	<0.01	达标
18	锰	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.1	0.00192	达标
19	铜	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	1.0	<0.00009	达标
20	锌	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	1.0	<0.009	达标
21	铝	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.2	<0.009	达标
22	砷	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00028	达标





序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
23	硒	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00172	达标
24	汞	原子荧光法	mg/L	0.001	<0.00004	达标
25	镉	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.005	<0.00006	达标
26	铅	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	<0.00007	达标
27	菌落总数	平皿计数法	CFU/mL	100	150	超标
28	总大肠菌群	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
29	耐热大肠菌群	多管发酵法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
30	大肠埃希氏菌	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
31	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	Bq/L	0.5	0.142	达标
32	总 β 放射性	薄样法	Bq/L	1	0.110	达标
33	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.06	<0.00003	达标
34	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.002	<0.00021	达标
35	亚硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.0024	达标
36	硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.005	达标
37	甲醛	乙酰丙酮分光光度法	mg/L	0.9	<0.05	达标
38	溴酸盐	离子色谱法	mg/L	0.01	<0.01	达标
39	游离氯	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	—	<0.02	—
40	一氯胺	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	—	<0.02	—
41	臭氧	靛蓝分光光度法	mg/L	—	<0.01	—
42	二氧化氯	甲酚红分光光度法	mg/L	—	<0.02	—

以下空白





检测结果表

检测编号	2022-HJ0053	样品类型	未梢水	采样位置	位奇镇位奇中心小学	
取样日期	2022.01.07	收样日期	2022.01.07	检测日期	2022.01.07~20	
检测结果						
序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
1	色度	铂钴标准比色法	度	15	<5	达标
2	嗅和味	嗅气和尝味法	—	无异臭、 异味	无	达标
3	浑浊度	福尔马肼标准目视比浊法	NTU	3	<1	达标
4	肉眼可见物	直接观察法	—	无	无	达标
5	pH 值	玻璃电极法	无量纲	6.5-8.5	8.19	达标
6	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3	1.2	达标
7	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	mg/L	0.05	<0.002	达标
8	挥发酚	流动注射-4-氨基安替比林分光光度法	mg/L	0.002	<0.001	达标
9	阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法	mg/L	0.3	<0.04	达标
10	硝酸盐 (以 N 计)	紫外分光光度法	mg/L	10	2.2	达标
11	氟化物	离子选择电极法	mg/L	1.0	0.186	达标
12	溶解性总固体	称量法	mg/L	1000	640	达标
13	总硬度	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	450	410	达标
14	氯化物	滴定法	mg/L	250	74.5	达标
15	硫酸盐	滴定法	mg/L	250	172	达标
16	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	<0.004	达标
17	铁	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.3	<0.01	达标
18	锰	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.1	0.0123	达标
19	铜	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	1.0	<0.00009	达标
20	锌	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	1.0	<0.009	达标
21	铝	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.2	<0.009	达标
22	砷	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00038	达标



检测结果表

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
23	硒	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00153	达标
24	汞	原子荧光法	mg/L	0.001	<0.00004	达标
25	镉	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.005	<0.00006	达标
26	铅	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	<0.00007	达标
27	菌落总数	平皿计数法	CFU/mL	100	未检出	达标
28	总大肠菌群	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
29	耐热大肠菌群	多管发酵法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
30	大肠埃希氏菌	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
31	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	Bq/L	0.5	0.108	达标
32	总 β 放射性	薄样法	Bq/L	1	0.076	达标
33	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.06	<0.00003	达标
34	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.002	<0.00021	达标
35	亚硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.0024	达标
36	硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.005	达标
37	甲醛	乙酰丙酮分光光度法	mg/L	0.9	<0.05	达标
38	溴酸盐	离子色谱法	mg/L	0.01	<0.01	达标
39	游离氯	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	0.05-4	0.05	达标
40	一氯胺	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	0.05-3	0.06	达标
41	臭氧	靛蓝分光光度法	mg/L	0.02	<0.01	达标
42	二氧化氯	甲酚红分光光度法	mg/L	0.02-0.8	0.04	达标

以下空白





检测结果表

检测编号	2022-HJ0054	样品类型	未梢水	采样位置	邮苑大酒店	
取样日期	2022.01.07	收样日期	2022.01.07	检测日期	2022.01.07~20	
检测结果						
序号	项目	检测方法	单位	标准限值	测定值	判定
1	色度	铂钴标准比色法	度	15	<5	达标
2	嗅和味	嗅气和尝味法	—	无异臭、 异味	无	达标
3	浑浊度	福尔马肼标准目视比浊法	NTU	3	<1	达标
4	肉眼可见物	直接观察法	—	无	无	达标
5	pH 值	玻璃电极法	无量纲	6.5-8.5	8.12	达标
6	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3	1.1	达标
7	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	mg/L	0.05	<0.002	达标
8	挥发酚	流动注射-4-氨基安替比林分光光度法	mg/L	0.002	<0.001	达标
9	阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法	mg/L	0.3	<0.04	达标
10	硝酸盐 (以 N 计)	紫外分光光度法	mg/L	10	1.96	达标
11	氟化物	离子选择电极法	mg/L	1.0	0.172	达标
12	溶解性总固体	称量法	mg/L	1000	570	达标
13	总硬度	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	450	377	达标
14	氯化物	滴定法	mg/L	250	60.3	达标
15	硫酸盐	滴定法	mg/L	250	150	达标
16	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	<0.004	达标
17	铁	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.3	<0.01	达标
18	锰	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.1	0.00810	达标
19	铜	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	1.0	<0.00009	达标
20	锌	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	1.0	<0.009	达标
21	铝	电感耦合等离子体发射光谱法	mg/L	0.2	<0.009	达标
22	砷	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00025	达标





检测结果表

序号	项目	检测方法	检测单位	标准限值	测定值	判定
23	硒	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	0.00175	达标
24	汞	原子荧光法	mg/L	0.001	<0.00004	达标
25	镉	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.005	<0.00006	达标
26	铅	电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.01	<0.00007	达标
27	菌落总数	平皿计数法	CFU/mL	100	未检出	达标
28	总大肠菌群	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
29	耐热大肠菌群	多管发酵法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
30	大肠埃希氏菌	酶底物法	MPN/100mL	不得检出	未检出	达标
31	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	Bq/L	0.5	0.194	达标
32	总 β 放射性	薄样法	Bq/L	1	0.190	达标
33	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.06	<0.00003	达标
34	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.002	<0.00021	达标
35	亚硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.0024	达标
36	硝酸盐	离子色谱法	mg/L	0.7	<0.005	达标
37	甲醛	乙酰丙酮分光光度法	mg/L	0.9	<0.05	达标
38	溴酸盐	离子色谱法	mg/L	0.01	<0.01	达标
39	游离氯	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	0.05-4	0.06	达标
40	一氯胺	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	mg/L	0.05-3	0.06	达标
41	臭氧	靛蓝分光光度法	mg/L	0.02	<0.01	达标
42	二氧化氯	甲酚红分光光度法	mg/L	0.02-0.8	0.04	达标

以下空白

